Kit mobile iECG LevMed

Suivez ces instructions étape par étape :

Après avoir terminé chaque étape, passez à la diapositive suivante.

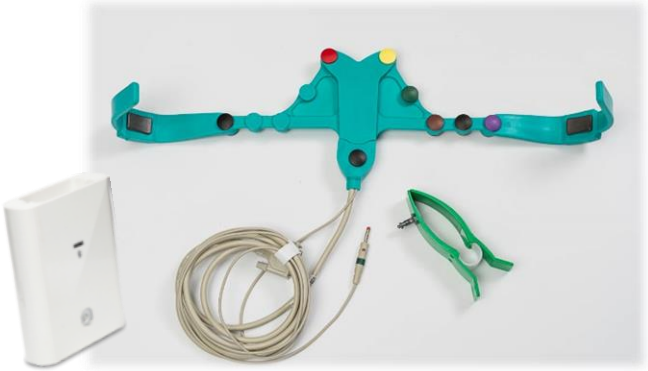

iECG

Ceinture ECG dédiée

Vérifiez que le câble de la ceinture ECG est connecté à l'appareil ECG.

1. Ouvrez la vis de l'électrode à pince verte.
2. Insérez la dérivation à fiche banane.
3. Fermez la vis.

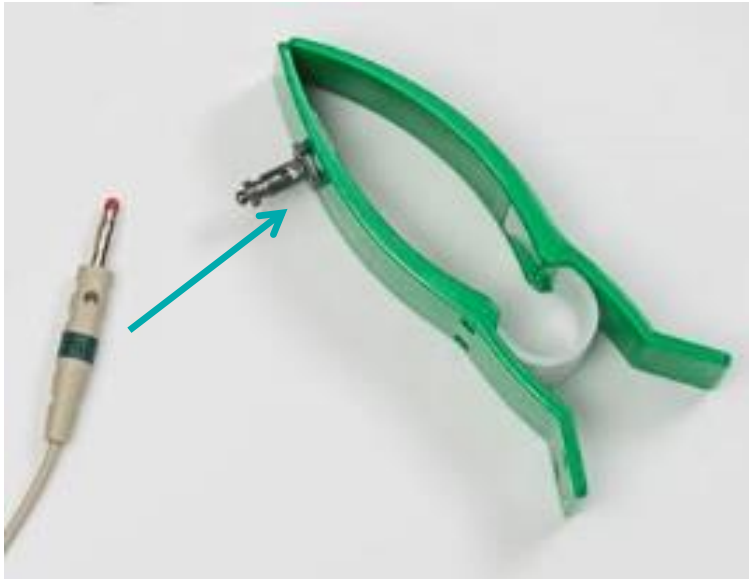

Ouvrez ou retirez la chemise du patient :

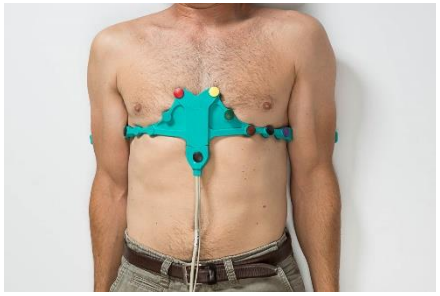

Humidifiez les 9 électrodes avec de l'eau du robinet :

(V1 à V6, RA, LA, RL)

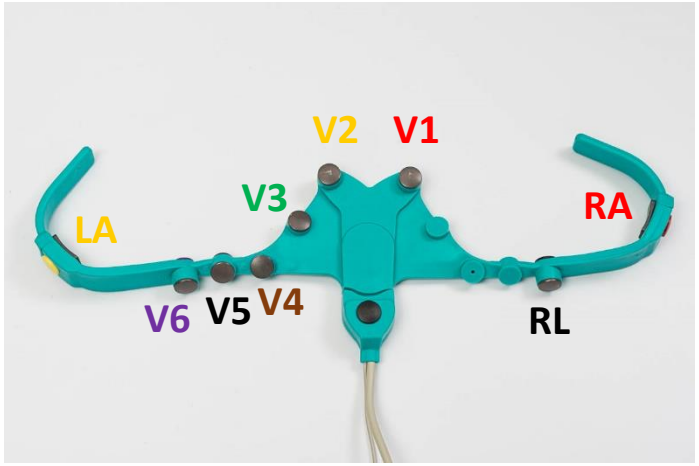

Si nécessaire, inclinez V1 et V2 pour garantir le contact des électrodes avec la poitrine du patient :

Placez la ceinture sur le torse du patient avec V1 et V2 de façon symétrique des deux côtés du sternum :

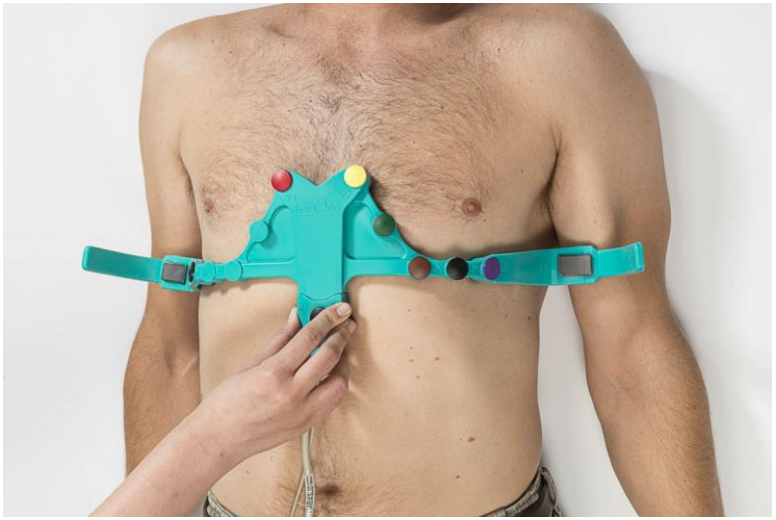

Appliquez la première anse sous le bras à mi-hauteur, entre le coude et l'épaule :

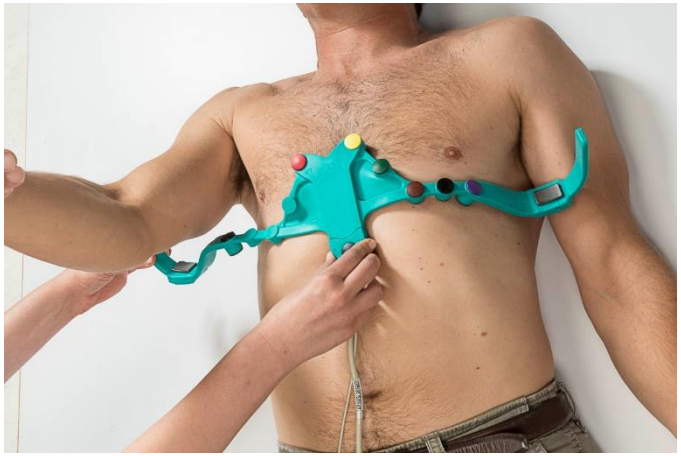

Lev ed

Appliquez la seconde anse sous l'autre bras à mi-hauteur, entre le coude et l'épaule :

Vérifiez que les électrodes V4, V5 et V6 se trouvent sous la poitrine :

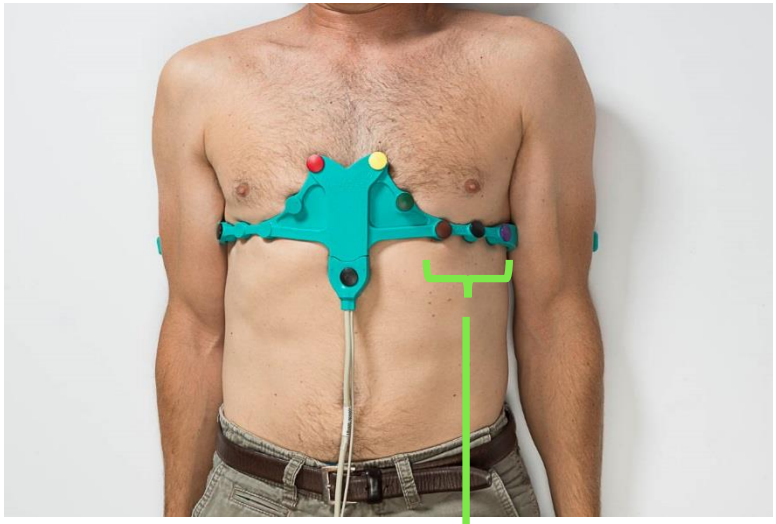

Assurez-vous que les 9 électrodes sont en contact avec la surface cutanée :

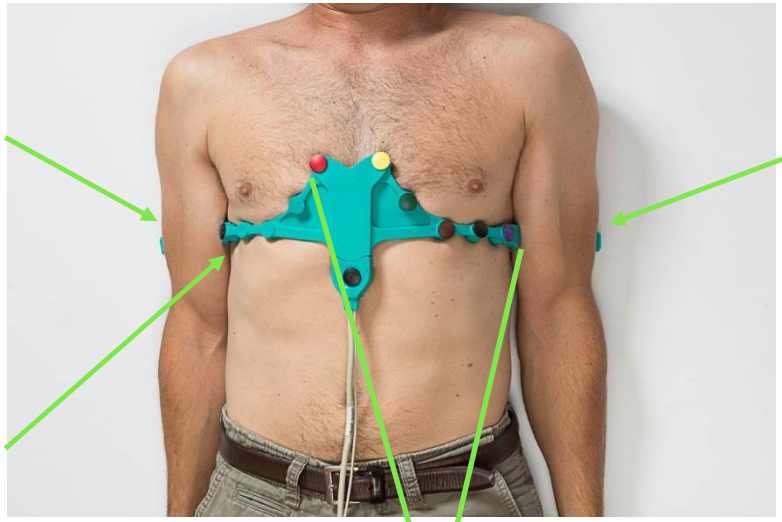

Électrode bras droit (RA)

Électrode bras gauche (LA)

Électrode de masse (RL)

6 électrodes thoraciques (V1 à V6)

Humidifiez l'électrode à pince verte avec de l'eau du robinet :

Appliquez l'électrode à pince verte sur la jambe gauche :

Assurez-vous que le patient est détendu et ne contracte pas ses muscles.

Demandez au patient de ne pas parler ni bouger pendant l'examen.

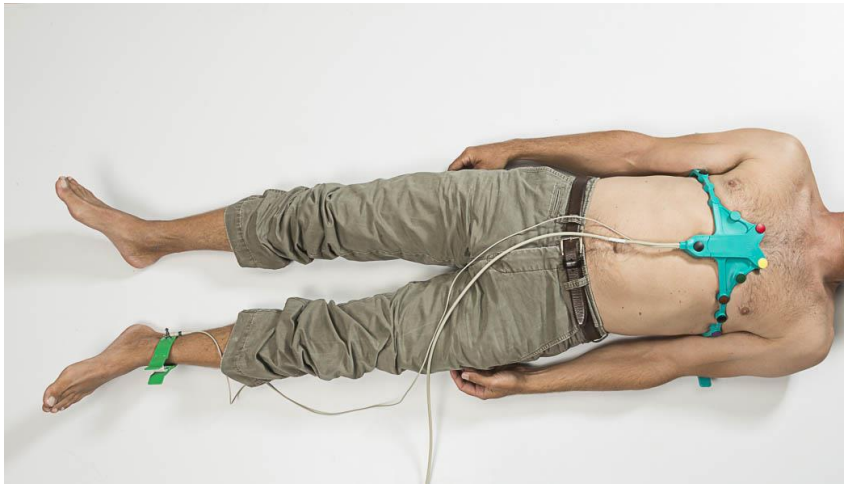

Appuyez sur « Démarrer » sur l'appareil ECG pour lancer l'acquisition ECG.

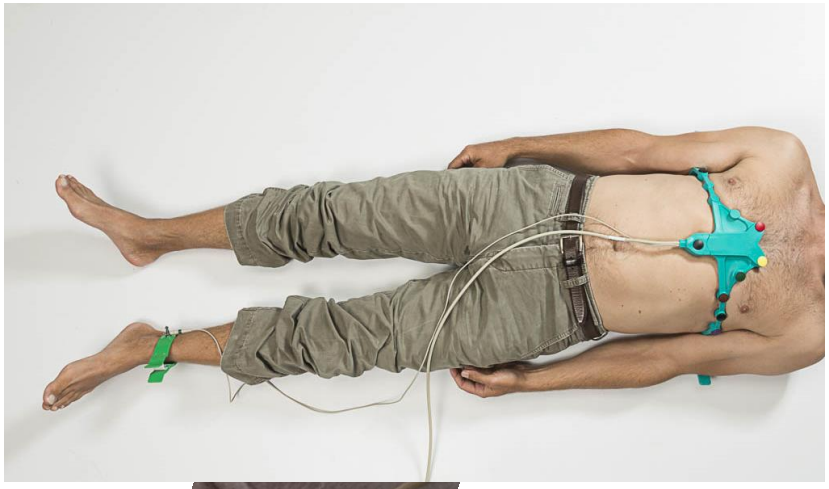

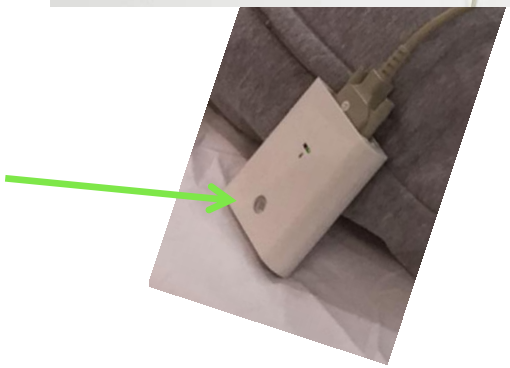

Ouvrez *l'application iECG* de votre appareil iOS.
Enregistrez l'acquisition ECG.

Suivez ces étapes dans votre application iPhone :

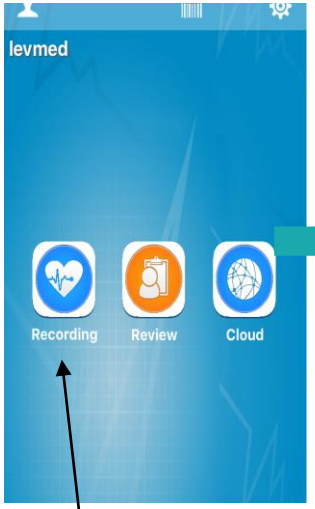

Cliquer sur « Enregistrement »

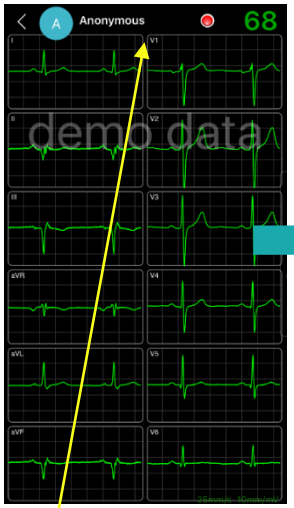

Cliquer sur le cercle rouge pour enregistrer et sauvegarder l'affichage

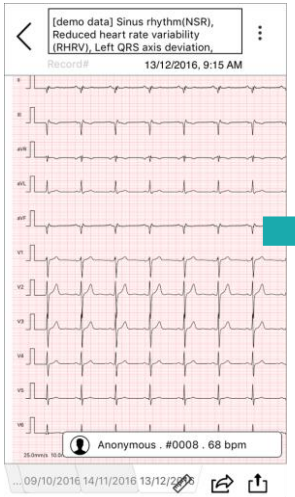

Cliquer pour ajouter des informations sur le patient

Cliquer pour envoyer par e-mail

Cliquer pour télécharger sur le Cloud

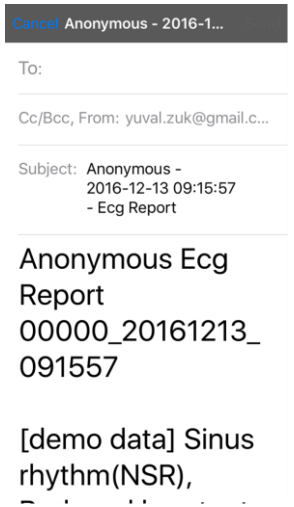

Envoyer par e-mail

Dépannage

En cas de bruit sur le signal ECG, vérifiez les points suivants :

1. De l'eau a été appliquée sur toutes les électrodes.
2. Toutes les électrodes sont en contact direct avec la surface cutanée.
3. Le patient est détendu, ses muscles ne sont pas contractés.

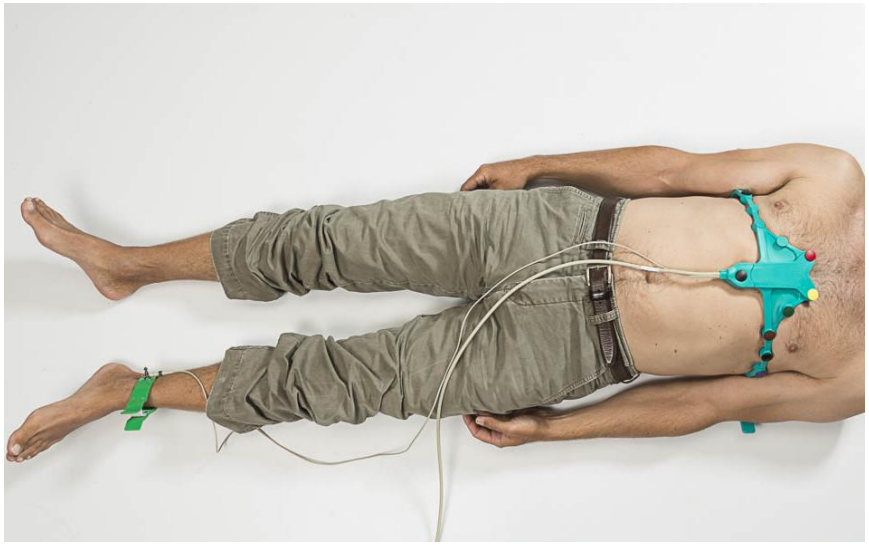

LevMed

Keeping Health Simple™

Merci d'utiliser LevMed Mobile iECG et la ceinture ECG dédiée !

Pour plus d'informations, contactez-nous à l'adresse

info@levmed.net

www.levmed.net